

Kłodzko, dnia 17.11.2023r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej art. biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, worków, myszek i klawiatur komputerowych. dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP.2510.12.2023.

Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pyt.1

Pakiet 9 poz. 1-5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższych pozycjach elektrod równoważnych wskazanych w kolumnie nr 11- szczegółowy opis pozycji. Proponowany przez Państwa opis elektrod wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.2

Poz. 1- Elektrody do defibrylacji dla dorosłych Quik-Combo (para), elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, w celu zapewnienia niezawodność połączenia, elektrody z technologią rastrową i owalnym kształtem zastosowane celem zmniejszenia podrażnień skóry, doskonała radioprzezierność, opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu, zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl, powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 102 cm², pary – 204 cm², pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, potwierdzona nawet po długotrwałej współpracy z rozrusznikiem zewnętrznym, to nic innego jak elektroda **11996-000090 firmy Physio Control**

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.3

Poz. 2- Elektroda EKG jednorazowego użytku, dla dorosłych do badań wysiłkowych, badań wykonanych na OIOM-ie oraz wszędzie tam, gdzie wskazany jest ciągły dozór kardiologiczny, ze stykiem Ag/AgCl, podłożem typu micropore, materiałowym, hydrożel, złącze zatrzaskowe, okrągła O 55 mm, całkowita powierzchnia 2376 mm², powierzchnia żelu 254 mm², grubość 0.7 mm, odporność na odrywanie min. 2.5N, opakowanie a' 30-50 sztuk, to nic innego jak elektroda **H99SG firmy Cardinal Health**

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.4

Poz. 3- Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku, (b.mocny, łagodny dla skóry klej), rozmiar 57×34 mm, ze złączem zatrzaskowym, całkowita powierzchnia 1522 mm², powierzchnia żelu 254 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie min. 5N, opakowanie a' 30-50 sztuk k, to nic innego jak elektroda **H91SSG firmy Cardinal Health**

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.5

Poz. 4 Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań diagnostycznych, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku (łagodny dla skóry klej), nadają się też do zastosowań w neurologii i pediatrii, rozmiar 43×35 mm, złącze zatraskowe; radioprzezierna, nadaje się do CT i MRI, całkowita powierzchnia 1182 mm², powierzchnia żelu 254 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie min. 4N, opakowanie a' 30-50 sztuk , to nic innego jak elektroda **H135TSG firmy Cardinal Health**

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.6

Poz. 5- Elektrody do EKG jednorazowego użytku dla dzieci i nieowłąt, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku, rozmiar 30×24 mm /O 24 mm/ złącze zatraskowe, całkowita powierzchnia 565 mm², powierzchnia żelu 201 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie min. 2.5N, opakowanie a' 30-50 sztuk , to nic innego jak elektroda **H124SG firmy Cardinal Health.**

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pozycja 1 – wycinek z katalogu Physio Control



- Doskonała radioprzezierność¹
- Elektrody Medi-Trace™ Cadence RTS podłączane są bezpośrednio do sprzętu dla zapewnienia skutecznego połączenia
- Opatentowana technika gradientowa i owalny kształt pozwalają na równomierne rozłożenie energii
- Zgodność ze sprzętem OEM eliminuje potrzebę stosowania specjalnych przejściówek i manipulacje przewodami
- Opakowania kodowane kolorami z rysunkami złączy ułatwiają i przyspieszają identyfikację produktu
- Zintegrowane odprowadzenia o długości do 117 cm pozwalają na wygodniejszą pracę z produktem
- Warstwa przewodząca wykonana z Ag/AgCl
- Powierzchnia przewodząca pojedynczej elektrody dla dorosłych wynosi 102 cm² (204 cm² na parę), a elektrody dla dzieci 55 cm² (111 cm² na parę)
- Pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, nawet po długotrwałej stymulacji zewnętrznej.

Poz. 2-5- wycinek z katalogu

Nazwa	Nr ref.	Rozmiar	Żel		Tworzywo			Rtg
			Żel płynny*	Hydrożel	Pianka	Folia	Mikro-guma	
H345G	31.1946.21	50x45 mm		•	•			•
H925G	31.1925.21	57x34 mm		•	•			
H9155G	31.1917.21	57x34 mm		•	•			
H91T5G	31.1915821	57x34 mm		•	•			•
H935G	31.1935.21	42x24 mm		•	•			
H1355G	31.1355.21	43x35 mm		•	•			
H135T5G	31.1355821	43x35 mm		•	•			•
H1245G	31.1245.21	30x24 mm		•	•			
H34LG	31.1345.21	50x45 mm	•		•			
H985G	31.1986.21	Ø 55 mm		•			•	
H995G	31.1996.21	Ø 55 mm		•				•
Medi Trace™ 100	31118733	Ø 30 mm		•	•			
Medi Trace™ 133	31439725	Ø 30 mm		•	•			
Medi Trace™ 200	31050522	Ø 35 mm		•	•			
Medi Trace™ 530	31013926	Ø 45 mm		•	•			
H59P	E540076	35x22 mm		•				•
H69P	E540291	22x22 mm		•				•
Medi Trace™ 700	22700	Ø 45 mm		•		•		

Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dostawca sprzętu Cardinal Health.. Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach.

Pyt.7

Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrod **równoważnych**:

Pozycja 1- Elektrody do defibrylacji dla dorosłych Quik-Combo (para), elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, elektrody o owalnym kształcie, doskonała radioprzezierność, opakowania z nadrukowanymi schematami połączeń, zintegrowane odprowadzenia długości 100 cm, powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 95 cm², pary – 190 cm², pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.8

Pozycja 2- Elektroda EKG jednorazowego użytku, dla dorosłych do badań wysiłkowych, badań wykonanych na OIOM-ie oraz wszędzie tam, gdzie wskazany jest ciągły dozór kardiologiczny, ze stykiem Ag/AgCl, podłożem materiałowym, hydrożel, złącze zatrząskowe,

okrągła O 50 mm, całkowita powierzchnia 1963,5 mm², powierzchnia żelu 176,71 mm², grubość 0.2 mm , odporność na odrywanie średnio 5N opakowanie a' 50 sztuk

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.9

Pozycja 3- Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku, (b.mocny, łagodny dla skóry klej), rozmiar 50×35 mm, ze złączem zatrzaskowym, całkowita powierzchnia 1558,23 mm², powierzchnia żelu 176,71 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie średnio 19N, opakowanie a' 50 sztuk

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.10

Pozycja 4- Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań diagnostycznych, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku (łagodny dla skóry klej), nadają się też do zastosowań w neurologii i pediatrii, rozmiar 42×45 mm, złącze zatrzaskowe; radioprzezierna, nadaje się do CT i MRI, całkowita powierzchnia ,opakowanie a' 50 sztuk.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.11

Pozycja 5- Elektrody do EKG jednorazowego użytku dla dzieci i niemowląt, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku, kształt kwiatka , rozmiar 25,7mm , złącze zatrzaskowe, całkowita powierzchnia 603,52 mm², powierzchnia żelu 226,98 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie średnio 9N, opakowanie a' 50 sztuk

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.12

Pakiet 9 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymaganych ilości elektrod. Zamawiający oczekuje 50 opakowań elektrod pakowanych od 30 do 50sztuk. Prosimy o podanie sztuk wymaganych elektrod.

Odp. 2500szt elektrod

Pyt.13

Pakiet 38 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o wymiarach 150x100x150.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.14

Pakiet 38 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie wymaganego papieru: czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy dopuszcza też papier kompatybilny innego producenta niż Mitsubishi?

Odp. Dopuszcza też zamiennik

Pyt.15

Pakiet 38 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o rozmiarze 107mm x 23m.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.16

Pytania do pakietu 23 Oit 1

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki wyłącznie w wersji prostej, o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności:

a) Zestaw dializacyjny permanentny (stały) 15,5F, wykonany w technologii typu ENDEXO – materiał odporny na odkładanie się skrzeplin. Zestaw, w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip) Pakowane pojedynczo.

Długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm, 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 43/48cm do




wyboru przez Zamawiającego

- zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji,
 - końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,
 - osobny kanał dla przewodnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły,
 - posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,
 - wykonany w innowacyjnej technologii Endexo, co sprawia, że materiał cewnika jest bardziej odporny na gromadzenie się elementów krwi w porównaniu do standardowych cewników niepowlekanych,
 - końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu
- Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielalny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne

Lub:

b) Czy Zamawiający dopuści cewnik długoterminowy 14F o długościach długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm, 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 35/40cm, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich wykonany z biokompatybilnego karbotanu cewnik odporny na rozpuszczalniki i na wszystkie powszechnie stosowane roztwory czyszczące na bazie jodu i alkoholu, wytrzymały na rozciąganie, elastyczny, odporny na załamania, posiadający solidne złącza typu luer i zaciski oznaczone kolorami, z nadrukiem objętości na ramionach, obrotowe skrzydełka do mocowania, miękka stopniowana końcówka cewnika ułatwia płynne wprowadzanie i zmniejsza stopień recyrkulacji, skład zestawu: 1 x cewnik, 1 x 18g x 7cm igła introduktora z zaworem bocznym 1 x 0.035" x 70cm prowadnik nitinolowy z końcówką J, 2 x rozszerzacz naczynia, 1 x introduktor z odrywaną osłonką, 1 x mandryn tunelowy 1 x

strzykawka 10ml, 1 x Skalpel nr 11, 2 x Nasadki iniekcyjne, 1 x Bezszywowe urządzenie mocujące 2 x Opatrunek na ranę, 1 x Naklejka identyfikacyjna pacjenta

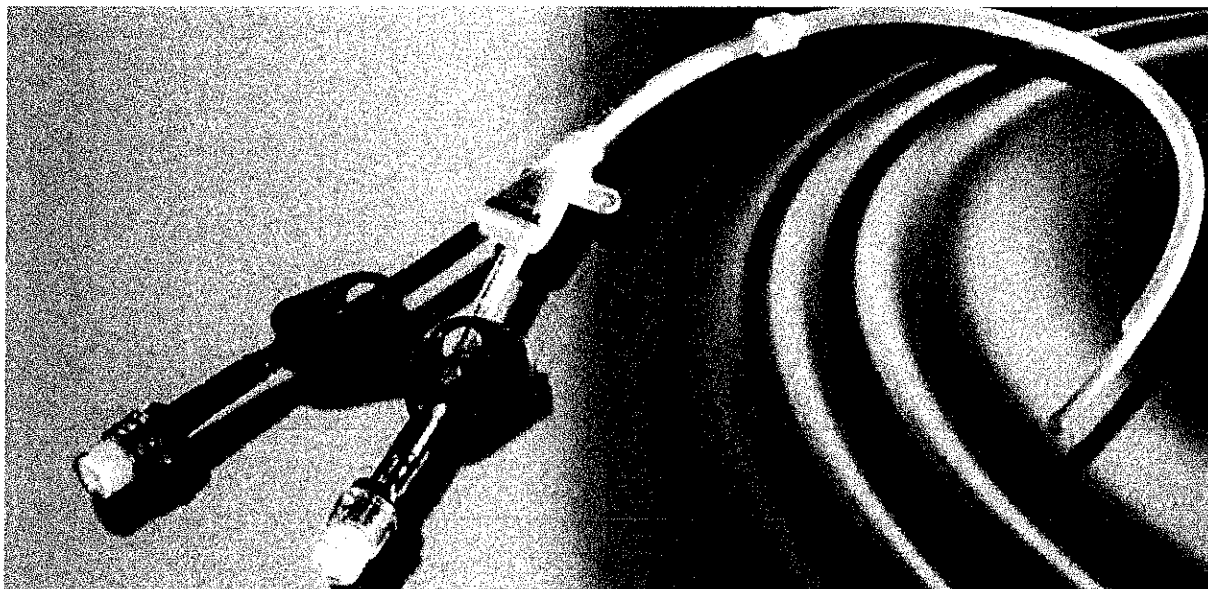

Na podstawie art 305 KK &1 (po nowelizacji z dn 1 X 2023) i art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję co działa na szkodę interesu publicznego a Zamawiający podał sztywne parametry techniczne. W przypadku odpowiedzi odmownej, aby zapewnić warunki równoważność produktu, prosimy podać rozwiązania funkcjonalne (lecznicze) jakie ma spełniać produkt, tak by zamawiający uzyskał urządzenie w pełni odpowiadające jego potrzebom i celowi zamówienia w oparciu o jego przeznaczenie a nie tylko sztywne dane techniczne

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.17

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia w pakiecie nr 16, w pozycji 1 pieluchomajtek dla dorosłych posiadających system szybkiego wchłaniania, który zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.18

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga w przedmiocie zamówienia w pakiecie nr 16, w pozycji 1 pieluchomajtek dla dorosłych, które posiadają w swej budowie minimum jeden ściągaczy taliowych? Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.19

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga w przedmiocie zamówienia w pakiecie nr 16 w pozycji 1, złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni, które są pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.20

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga w przedmiocie zamówienia w pakiecie nr 16, w pozycji 1 wymóg poziomu chłonności pieluchomajtek, co najmniej 2772g i nie dopuści do złożenia oferty z produktami o niższej chłonności?

Odp. Tak

Pyt.21

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w przedmiocie zamówienia w pakiecie nr 16 w pozycji 1 pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w bariery wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu, które nie chronią skutecznie przed wydostawaniem się zawartości na zewnątrz.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.22

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w pakiecie nr 16 w pozycji 1 pieluchomajtek dla dorosłych o wadze odpowiednio: rozmiar L - około 110g i rozmiar XL - około 121g?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.23

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w pakiecie nr 16, pozycja 1, pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone we wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem? (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozpływa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności a dodatkowo może wprowadzać w błąd opiekuna, który nie będzie w stanie ostatecznie stwierdzić, czy produkt kwalifikuje się już do zmiany czy jeszcze nie?)

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.24

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia w pakiecie nr 16, pozycja 1, pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone we wskaźnik wilgotności w postaci czarnego napisu z informacją o dacie i numerze serii produkcji, który rozpływa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności a dodatkowo może wprowadzać w błąd opiekuna, który nie będzie w stanie ostatecznie stwierdzić, czy produkt kwalifikuje się już do zmiany czy jeszcze nie?)

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.25

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o szacunkowe określenie zapotrzebowania w pakiecie nr 16, pozycja nr 1 na poszczególne rozmiary pieluchomajtek. W obecnej sytuacji jesteśmy zmuszeni zaproponować Państwu cenę za produkt o rozmiarze XL, co jest skrajnie nieopłacalne dla Państwa. Różnica w cenie pomiędzy poszczególnymi rozmiarami wynosi +/- 15% co w skali 12 miesięcy umożliwi Państwu zaoszczędzenie znacznej kwoty lub otrzymanie większej ilości produktów.

Odp. XL- ok.10% zamówienia, 90%- rozmiar L

Pyt.26

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w pakiecie nr 16, pozycja nr 1 złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej.

Nomenklatura nazw handlowych może być różna, ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.27

Czy Zamawiający w pozycji 1 część 23 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z rozrywalną koszulką z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR, ramiona proste i długościach: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm 33/54 cm do wyboru przez Zamawiającego

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.28Dotyczy części 33 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielone po obwodzie, powierzchnia 110cm², wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt.?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.29Pytanie 2 do części 33 pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrod jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma przyciskami, długość 160mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 5m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową / opakowanie 50 szt.?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.30

Pakiet 33, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.31

Pakiet 33, pozycja 2:

Jaki rodzaj wtyku Zamawiający wymaga np.: 1 pin, 3 pin?

Odp. 3 PIN

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

DYREKTOR
„Zespół Opieki Zdrotnej” w Rodolesie
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a
dr n. o zek. Janina Nadziejewska