

Kłodzko, dnia 16.07.2025r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do elektroporacji, obłożenia do kardioablacji oraz sprzęt do wymiany stymulatorów dwujamowych z funkcją resynchronizacji serca z fizycznym czujnikiem adaptacji stymulacji do życia i stanu zdrowia pacjenta dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

Informujemy, że Wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 1.

Dotyczy Pakietu 4.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie również koszulek i igieł do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej o następujących parametrach opisanych poniżej. **Pozytywne odpowiedzi na pytanie poszerzą grono oferentów, co z pewnością wpłynie korzystnie na sytuację ekonomiczną szpitala, jednocześnie zapewniamy, że parametry jakościowe nie odbiegają w żaden sposób od tych opisanych w SIWZ;**






KOSZULKA


- Koszulka ZBROJONA do wyboru 8Fr oraz 8.5Fr o długości: **62 cm (wymagane 63-65cm)**
- Prowadnik 0,032", 180cm
- Atraumatyczna końcówka z wysoką widocznością w skopii
- Do wyboru krzywizny koszulek, odpowiadające SL0, SL1, SR0, LAMP;

IGŁA

- dostępne 2 różne krzywizny odpowiadające BRK i BRK1 - 71cm
- igła wykonana w całości ze stali Z WYGODNĄ RĘKOJĘŚCIĄ PCV - DO ROTACJI/MANIPULACJI – DODATKOWA KORZYŚĆ
- dostępna igła extra ostra - do łatwiejszego nakłucia przegrody

Zdjęcia produktu poniżej:

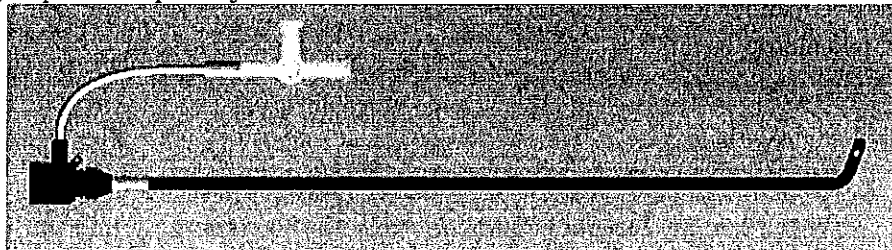

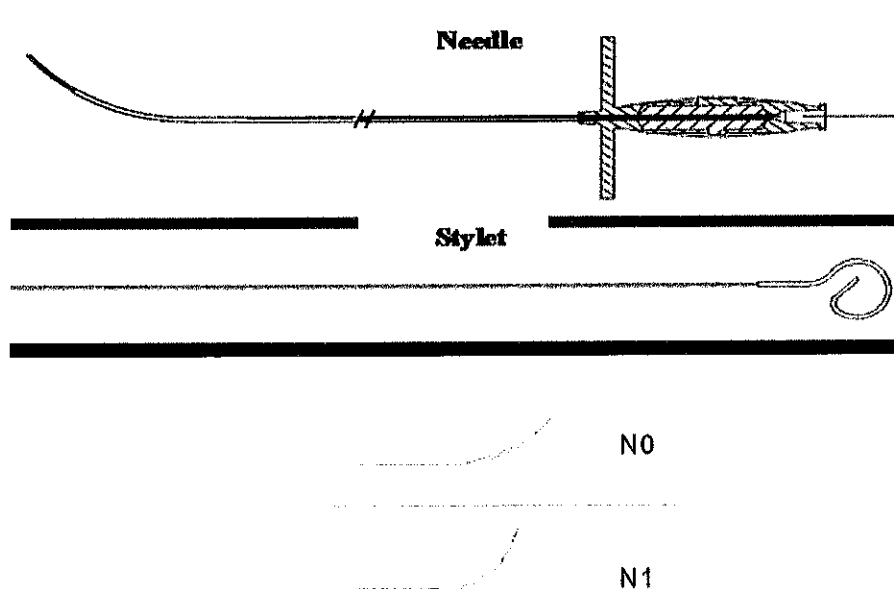

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Dotyczy Pakietu 5.

Prosimy o dopuszczenie koszulek Peel - Away spełniających wszystkie warunki SWZ, dostarczane w opakowaniu sterylnym typu papier – folia + kartonowe opakowanie zewnętrzne.

Zestaw zawiera:

1. Introduktor o długości **13,5cm** składający się z rozszerzacza (dylatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu).
2. Prowadnik $\varnothing 0,38''$, długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym. Prowadnik umieszczony jest w osłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostującym do umieszczania końcówki „J” w igle.
3. Igła introduktora, rozmiar 18 G, długość 7 cm.
4. Strzykawka, pojemność 10 ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto” ?

Odp. Zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 4**Pakiet 2****Składowa 1**

Czy Zamawiający dopuści chustę angiograficzną o wym. 217cm x 320cm wykonaną z tkaniny SMS z dwoma okrągłymi otworami o śr. 12cm wypełnionymi folią chirurgiczną. Otwory umieszczone 53cm od górnego brzegu serwety. Wzmocnienie w strefie krytycznej o wym. 80cm x 120cm. Przezroczysty panel z prawej strony o wym. 57cm x 320cm?

Składowa 6

Czy Zamawiający dopuści ręczniki z włókniny spunlace 30cm x 30cm?

Składowa 7

Czy Zamawiający dopuści standardowy skalpel z ostrzem FIG 11?

Składowa 10

Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne 15cm?

Składowa 11

Czy Zamawiający dopuści tolerancję dł. kleszczyków mosquito +/- 0,5cm?

Składowa 12

Czy Zamawiający dopuści chustę do spakowania zestawu na stolik z tolerancją wymiarów +/- 2cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 5**Pakiet 6****Składowa 1**

Czy Zamawiający dopuści chustę angiograficzną o wym. 217cm x 320cm wykonaną z tkaniny SMS z dwoma okrągłymi otworami o śr. 12cm wypełnionymi folią chirurgiczną. Otwory umieszczone 53cm od górnego brzegu serwety. Wzmocnienie w strefie krytycznej o wym. 80cm x 120cm. Przezroczysty panel z prawej strony o wym. 57cm x 320cm?

Składowa 4

Czy Zamawiający dopuści powłokę ochronną typu czapeczka o wym. 85cm x 85cm, zamiast 85 x 90cm?

Składowa 8

Czy Zamawiający dopuści ręczniki z włókniny spunlace 30cm x 30cm?

Składowa 9

Czy Zamawiający dopuści chustę do spakowania zestawu na stolik z tolerancją wymiarów +/- 2cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

K. Sz.

J.G.

DYREKTOR
„Zespół Opieki Zdrotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a

dr n. o zdr. Jolanta Radziejewska

